

SPIS TREŚCI

stron dokumentu: 14

zestaw 1 [zam.: 17.06.2022]	2
zestaw 2 [zam.: 22.06.2022]	6

zestaw 1

zam.: 17.06.2022 r.

1

[pakiet 16](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 140 cm
- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 172 cm H₂O, chłonność 330%. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2

[pakiet 16](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m². Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H₂O, chłonność 348%. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

3

[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści komplety w rozmiarach S – XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

4

[pakiet 4, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100 sztuk z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

5

[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

6

[pakiet 8, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

7

[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch jałowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

8

[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

9

[pakiet 8, poz. 2](#)**Pytanie:**

Pakiet 8 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 140 cm (określony przez producenta jako XXL)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje fartuch o dolnym **obwodzie** min. 150 cm, a nie długości.

Dopuszcza się inne określenie rozmiaru przez producent niż 'XL' o ile spełnione zostaną pozostałe kryteria SWZ.

10

[pakiet 8, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o łącznej gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

11

[pakiet 8, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym (odpowiadający XL)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

12

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści fartuchy z rękawem typu prostego (nie reglan)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści fartuchy w rozmiarach M – XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

14

[pakiet 14, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 100 x150 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie ze SWZ.Podany w pytaniu wymiar mieści się w oczekiwanych zakresach.

15

[pakiet 15, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze podstawowej 118g/m² i chłonności min. 35ml/100cm²?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

16

[pakiet 15, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podkład zakończony marginesami po dłuższych bokach i rdzeniem chłonnym na całej długości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

17

[pakiet 15, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści maty 81 x 120 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

18

[pakiet 15, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową o chłonności 9 litrów wody lub 3,5 litra 0,9%NaCl w rozmiarze 72 x 37 cm. Mata zbudowana z rdzenia celulozy i poliaktyanu sodu, pokrycie z polipropylenu nietkanego. Produkt pakowany a'25 sztuk w torbę do powieszenia na ścianie? Niesterylny. Pochłonięty płyn pozostaje wewnątrz tkaniny i zmienia się w żel.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

19

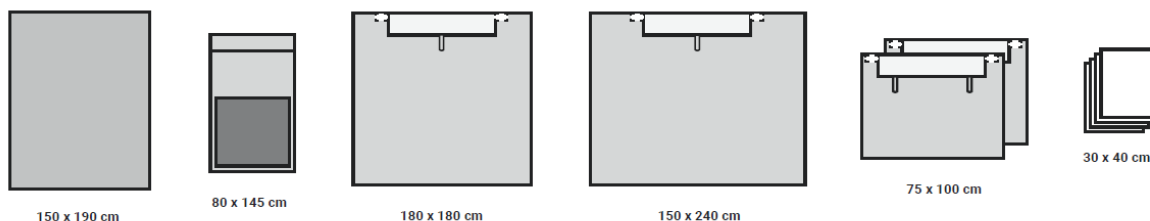
[pakiet 16](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

20

[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego dostępnego w rozmiarach M, L, XL, XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

21[pakiet 3, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompletu chirurgicznego posiadającego dekolt z wycięciem w kształcie U?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

22[pakiet 4, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli operacyjnej dla pacjenta będącej wyrobem higienicznym i opodatkowanej stawką podatku VAT 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

23[pakiet 5, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwiu pakowanych w opakowanie a'250par (czyli 500szt.), z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości, czyli wyceny 30 op. a'250par?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

1*pakiet 9, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści podkład o długości 40 m z przeliczeniem zamawianych ilości, tj. 450 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

2*pakiet 4, poz. 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę z opakowanie a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

3*pakiet 4, poz. 3***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę z opakowanie a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

4*pakiet 7, poz. 1÷2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę z opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

5*pakiet 12, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem o kroju prostym zapewniającym swobodę ruchów, dostępny w rozmiarze M-XXXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w zakresie oraz minimalnego zakresu dostępnych rozmiarów (z „S-XXL/2XLL” na „minimum M-XXL/XLL”).

Pozostałe parametry bez zmian.

6*pakiet 12, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy > 100 cm H₂O w obszarze krytycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

7*pakiet 12, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze min. 35 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

8*pakiet 15, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pikowany podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², waga całkowita podkładu 280 g ±5g, o chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

9

[pakiet 15, poz. 2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji nr 2 do osobnego pakietu.

Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji z pakietów.

10

[pakiet 15, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści pikowany podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, o chłonności 3820,18 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

11

[pakiet 15, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm; mata dwuwarstwowa: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE, w opakowaniu 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

12

[pakiet 15, poz. 4](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową umożliwiającą wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność ok 7l wody, min. 3 litry soli fizjologicznej), dwustronną, chłonną od góry oraz od spodu; z wkładem chłonnym wyposażonym w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu; rozmiar 75x36cm (wkład chłonny 68cmx30cm), w kolorze białym; w opakowaniu 100szt; warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej superabsorbent?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

13

[pakiet 16, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 x 60 cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Skład:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny spunlace
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Zestaw spełnia pozostałe wymagania.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

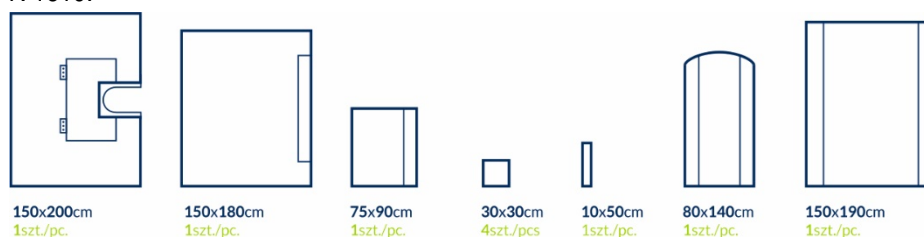
14

pakiet 17, poz. 1

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do operacji głowy/szyi o składzie:

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów, odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

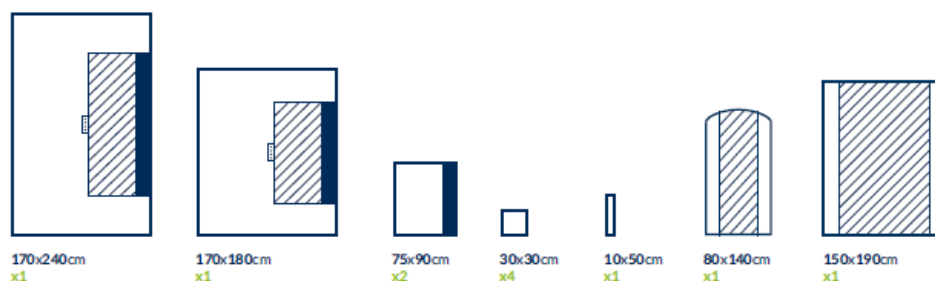
15

pakiet 18, poz. 1

Pytanie:Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny wykonany z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażone w wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów w składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
- 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m²
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm, wzmocnienie w rozmiarze 60 x 140 cm, pozostałe parametry zgodne
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm, z włókniny spunlace o gramaturze 68g/m²
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 65 x 190 cm

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

16

[pakiet 18, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw uniwersalny wzmocniony wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m² i wymiarach 25 x 60 cm, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m². Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Skład:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
 - 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
 - 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
 - 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
 - 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
 - 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm z włókniny spunlace
 - 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.
- Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

17

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z serwetami (pozycje 1-3 zestawu) ze wzmocnieniem o wymiarach 25 x 60 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

18

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z serwetą na stolik Mayo o wzmocnieniu 60 x 145 cm (zamiast 65 x 85 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

19

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z ręcznikami 30 x 30 cm (zamiast 20 x 30 cm (+/-5 cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

20

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z taśmą lepną z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 68g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

21

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z fartuchami ze wzmocnieniem w okolicy klatki piersiowej i brzucha oraz na rękawach wykonane z laminatu PP+PE 40g/m² i mankietem o dł. min. 7 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

22

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z osłoną na stół narzędziowy o wzmocnieniu 65 x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

23

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z kompresami gazowymi 45 x 45 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

24

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z ostrzami z poz. 15 i 16 z trzonkiem, bez osłonki?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

25

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z drenem o dł. 2,1m?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie ze SWZ.

26

[pakiet 18, poz. 3](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do amputacji kończyny z aspiracją typu yankauer 21CH, 4 otwory, regulacja ssania?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

27

[pakiet 10, poz. 1](#)**Pytanie:**

Prosimy o dopuszczenie podkładów o szerokości od 68cm do 75cm, ze względu na zakupiony tambor celulozy prześcieradła nie zawsze mają równe 70cm.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

28

[projekt umowy: § 6 ust. 2](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę §6 ust. 2 projektu umowy w sposób następujący:

*W przypadku nieusunięcia wad w przedmiocie realizacji umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości **10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy)** za każdy dzień zwłoki od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wady licząc osobno od każdego zgłoszenia wady.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

29

[projekt umowy: § 6 ust. 3](#)**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 3 projektu umowy w sposób następujący:

*Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) **wartości niewykorzystanej części umowy** w przypadku niewykonania przedmiotu umowy.*

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

30 [projekt umowy: § 6 ust. 4](#)

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 4 projektu umowy w sposób następujący:

W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po jednej ze Stron, Strona uprawniona może żądać od Strony zobowiązanej zapłaty kary umownej w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wartości niewykorzystanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.

31 [pakiet 11, poz. 2](#)

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

32 [pakiet 2, poz. 1÷2](#)

Pytanie:

Czy zamawiający wymaga/dopuszcza aby maski były zarejestrowane wyłącznie jako środek ochrony indywidualnej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ

Należy również zwrócić uwagę na odnośnik „*” - wymagania dodatkowe opisane poniżej tabeli.

33 [pakiet 3](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza:

bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

34 [pakiet 3](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści rozmiary S-XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

35 [pakiet 4, poz. 1÷2](#)

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

36 [pakiet 4, poz. 2](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści czepek z włókny PP, nieperforowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

37 [pakiet 7, poz. 1÷2](#)

Pytanie:

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową o gramaturze jednej warstwy ok. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Tak. Zgodnie ze SWZ minimalna gramatura 3 warstw to 70g/m².

38

[pakiet 7, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wymaga maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

39

[pakiet 7, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wyceny za 1 sztukę.

40

[pakiet 9](#)**Pytanie:**

Pakiet 9,

Czy zamawiający dopuszcza podkład składający się z warstwy folii i celulozy?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

41

[pakiet 10](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 80 cm, z perforacją co 50 cm, 160 szt. odcinków na rolce, celuloza o gramaturze 24 g/m², folia grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

42

[pakiet 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletów chirurgicznych w rozmiarach: S/M/L/XL/XXL. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

43

[pakiet 4, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszuli pacjenta wykonaną z nieprzezroczystej włókniny o gramaturze minimum 25g/m², krótki rękaw, wiązana w pasie i przy szyi, rozmiar L i XL, która nie jest wyrobem medycznym.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

44

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniacze na obuwiu wykonane z włókniny, krótkie, zakończone gumką.

Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

45

[pakiet 8, poz. 3](#)**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o gramaturze 40 g/m². Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

46

pakiet 12, poz. 1

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze min. 35 g/m², z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 70 g/m². Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami 30x39cm, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości. Dla obszaru krytycznego min. 175 cmH₂O. Dostępny w rozmiarach S/M-XLL.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w zakresie odporności na przenikanie w zakresie obszaru krytycznego (z minimum 190 na 175 cmH₂O) oraz minimalnego zakresu dostępnych rozmiarów (z „S-XXL/XLL” na „minimum M-XXL/XLL”).

Pozostałe parametry bez zmian.

47

pakiet 12, poz. 2

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gramatury 35g/m². Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

48

pakiet 16

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50μ z mikroteksturą ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm, składana rewersowo
- 2 x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm
- 1 x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów
- 1 x taśma lepna włókninowa 9X50 cm
- 4 x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylene, polietylen) o gramaturze max. 58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (współczynnik pylenia ≤1,7 log10). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyjących włókien wiskozy i celulozy (polipropylene 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepnią ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ.

49

pakiet 16

Pytanie:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego ze SWZ. Zamawiający wskazał dodatkowe wymagania dla obszaru wzmocnionego i podał wymiary tego obszaru dla każdej serwety. Dla pozostałego obszaru dopuszcza ale nie wymaga.

50

[pakiet 16](#)**Pytanie:**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje zestawów z potwierdzoną sterylnością. Nie stawia wymogów co do procesu jej przeprowadzenia.

51

[pakiet 12, poz. 1](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów chirurgicznych w rozmiarach M - XXXL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany w zakresie oraz minimalnego zakresu dostępnych rozmiarów (z „S-XXL/XLL” na „minimum M-XXL/XLL”).

Pozostałe parametry bez zmian.

52

[pakiet 17](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji szyi i głowy nie posiadającego w składzie 2 ręczników. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

53

[pakiet 17](#)**Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji szyi i głowy z oddzielnie pakowanymi 2 ręcznikami z podaniem łącznej ceny za komplet. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza osobne spakowanie ręczników o ile cena podana będzie za komplet.