

# SPIS TREŚCI

*stron dokumentu: 11*

zestaw 1 [zam.: 10.05.2024] .....	2
zestaw 2 [zam.: 14.05.2024] .....	4

**1***pakiet 8, poz. 1***Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie fartuchów o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym – min. 116,8 cm H<sub>2</sub>O. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza i dokona zmiany zapisu w SWZ.

**2***pakiet 16***Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji szyi i głowy nie posiadającego w składzie 2 ręczników. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**3***pakiet 16***Pytanie:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu do operacji szyi i głowy z oddzielnie pakowanymi 2 ręcznikami z podaniem łącznej ceny za komplet. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**4***pakiet 7, poz. 4***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m kw.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisu w SWZ.

**5***pakiet 16***Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 1 serweta- turban do okrycia głowy 2- częściowa: 130 x 100 cm (PP/ PE), 100 x 80 cm (P/PE/Spunlace) z 2 taśmami samoprzylepnymi
- 1 serweta z wycięciem U wzmocniona 225 cm x 300 cm, wycięcie 14 cm x 80 cm, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów.

Serweta z wycięciem U wykonana z laminatu 2-warstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup> (+/- 0,5 g/m<sup>2</sup>).

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

6

pakiet 18

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
- 1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150 x 250 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5 g/m<sup>2</sup>). Wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 20 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 174 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 348%. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

7

pakiet 19

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego wzmocnionego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 4 ręczniki 30 cm x 40 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm, zielona, z folii polietylenowej, obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 85 g/m<sup>2</sup> (+/-0,5g/m<sup>2</sup>), wielkość wzmocnienia 75 cm x 90 cm
- 1 taśma samoprzylepna włókninowa 9 cm x 50 cm
- 2 samoprzylepne serwety operacyjne 3-warstwowe 75 cm x 90 cm
- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 175 cm x 180 cm
- 1 samoprzylepna serweta 3-warstwowa 150 cm x 240 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu trzywarstwowego (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa) o gramaturze 74 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie cieczy 172 cm H<sub>2</sub>O, chłonność 330%. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Sterylizowany tlenkiem etylenu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**1***pakiet 6***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie podkładu o długości 40m z przeliczeniem na 125 rolek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**2***pakiet 8, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha z rękawami o kroju prostym, zapewniającym swobodę ruchów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**3***pakiet 8, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 102 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**4***pakiet 8, poz. 2***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**5***pakiet 16. poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (pozycja 2 zestawu) wymiarach 150 cm x 250 cm z wycięciem na krótszym boku 7 cm x 70 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**6***pakiet 16, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (pozycja 3 zestawu) typu turban o wymiarach 100 cm x 100 cm z zachowaniem pozostałych parametrów zgodnych z SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**7***pakiet 16, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (pozycja 3 zestawu) typu turban z wewnętrzną warstwą z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

---

**8***pakiet 17, poz. 1***Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą (pozycja 2 zestawu) o wymiarach 150 cm x 200 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

9

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z taśmą typu rzep o wymiarach 2 cm x 22 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

10

[pakiet 17, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z osłoną na stolik Mayo o wymiarach wzmocnienia 60 cm x 145 cm, o gramaturze folii PE 50g/m<sup>2</sup> oraz włókniny 37 g/m<sup>2</sup>, z barierowością dla wody 188 cm H<sub>2</sub>O?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

11

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o chłonności w strefie krytycznej 478%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

12

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetami obłożeniowymi ze wzmocnieniem o wymiarach 25 x 60 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

13

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą dolną (pozycja 3 zestawu) o wymiarach 180 x 180 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

14

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z ręcznikami 30 x 30 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisu w SWZ.

15

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu o chłonności w strefie krytycznej 420%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

16

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu wykonanego z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma poczwórnymi organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 136 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

17

[pakiet 18, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetami obłożeniowymi ze wzmocnieniem o wymiarach 35 x 80 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

18

[pakiet 19, poz. 1](#)**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą na stolik Mayo o wymiarach 80 x 145 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem SWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisu w SWZ.

19

[pakiet 1, poz. 2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m<sup>2</sup>, z warstwą pochłaniającą pot (50 g/m<sup>2</sup>) przedniej części o wymiarach 40 mm x 30 cm – z włókniny typu spunlance, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

20

[pakiet 3, poz. 1÷2](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, o gramaturze każdej warstwy ok. 25 g/m<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający oczekuje masek trzywarstwowych o łącznej gramaturze minimum 70 g/m<sup>2</sup>.

21

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

22

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

23

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 m, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podkłady o wymiarach 50 cm x 45,9 m z perforacją co 34 cm – zgodnych z SWZ.

24

[pakiet 5](#)**Pytanie:**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

**25**[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

**26**[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 m, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

**27**[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

**28**[pakiet 6](#)**Pytanie:**

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.


*Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie którejkolwiek pozycji z pakietu.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
Obłożenia medyczne jednorazowe

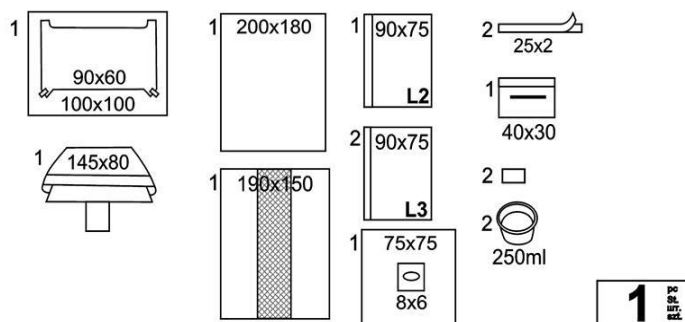

Opis składnika	Ilość
KIESZEŃ NA PŁYNY PE 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYL	1
SERWETA L2 90X75CM PRZYL 90	1
SERWETA L2 100X100CM (15)+90X60 PRZYL (TURBAN)	1
SERWETA L2 200X180CM	1
SERWETA L3 75X75CM OO8X6CM PRZYL	1
SERWETA L3 90X75CM PRZYL 90	2
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP	2
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1
TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM	2

Laminat L2 - Laminat o gram. 55g/m<sup>2</sup> spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana. Folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H<sub>2</sub>O, odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397,18 % i 218,45 ml/m<sup>2</sup>, o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.


**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.



**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
Obłożenia medyczne jednorazowe

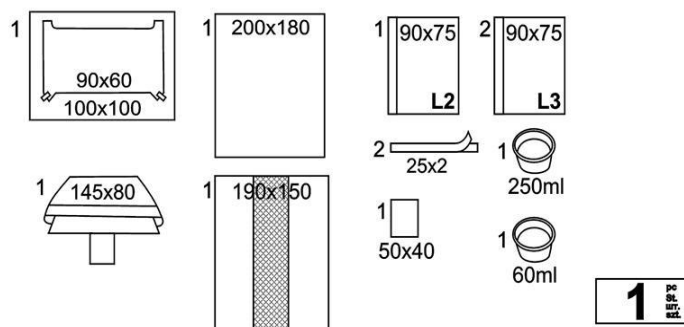

Opis składnika	Ilość
SERWETA L2 90X75CM PRZYŁ 90	1
SERWETA L2 100X100CM (15)+90X60 PRZYŁ (TURBAN)	1
SERWETA L2 200X180CM	1
SERWETA L3 90X75CM PRZYŁ 90	2
SERWETKA CELULOZOWA 50X40CM	1
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
POJEMNIK PLAST OKRĄG 60ML WYS 3CM ŚR DENKA 5,5CM SKALA TRANSP	1
POJEMNIK PLAST OKRĄG 250ML WYS 5,5CM ŚR DENKA 7CM SKALA MANKIET TRANSP	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1
TAŚMA RZEP, HACZYKI I PĘTELKI, BIAŁA 20X250MM	2


Laminat L2 - Laminat o gram. 55g/m<sup>2</sup> spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana. Folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H<sub>2</sub>O, odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397,18 % i 218,45 ml/m<sup>2</sup>, o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę i dokona zmiany zapisu w SWZ w zakresie chłonności.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:  
Obłożenia medyczne jednorazowe

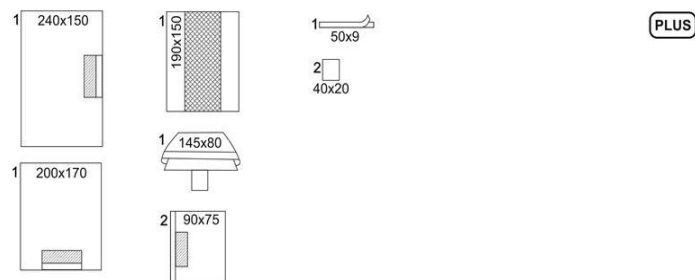

Opis składnika	Ilość
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2
SERWETA 240X150CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM	1
SERWETA 170X200CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X60CM	1
SERWETA 75X90CM L2-62G WARSTWA CHŁ 37,5X70CM PRZYL 5X90CM	2
POKROWIEC PE NA STOLIK MAYO PROSTOKĄT 145X80CM 30GSM 50MIC Z WARSTWĄ CHŁONNĄ 76X85CM NIEBIESKI	1
SERWETA NA STÓŁ INSTRUM 190X150CM	1
TAŚMA MEDYCZNA BP 9X50CM PRZYL	1

Laminat L2 - Laminat o gram. 55g/m<sup>2</sup> spełnia wymagania normy PN-EN 13795-1:2019 dla obłożeń chirurgicznych- potwierdzone raportem badań wykonanym w akredytowanym, niezależnym laboratorium. Folia laminatu jest trójwarstwowa oraz embosowana. Folia laminatu wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Laminat o odporności na przenikanie cieczy na poziomie min. 300 cm H<sub>2</sub>O, odporności wytrzymałość na wypychanie - na sucho na poziomie min. 247 Kpa, wytrzymałość na wypychanie - na mokro na poziomie min. 241 Kpa, o chłonności badanej wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 397,18 % i 218,45 ml/m<sup>2</sup>, o nasiąkliwości (metodą run off) wg. PN-EN ISO 9073-11 na poziomie min. 28,80 %, o sile delaminacji (włóknina/folia) na poziomie min. 1,91 N/25mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

32

pakiet 8, poz. 2

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego ubrania operacyjnego – komplet składający się z bluzy i spodni pakowanych oddzielnie, wykonane z nieprzejrzystej, miękkiej i przyjaznej w dotyku włókniny polipropylenowej SMS, o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>, nie zawierające lateksu. Włóknina zgodna z wymaganiami normy EN 13795 – 2, potwierdzone kartą techniczną materiału. Odporność na penetrację mikroorganizmów na sucho 6 CFU/100 cm<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozrywanie min. 100 kPa. Bluza szyta w ergonomicznym kształcie dzwonu umożliwiającym odpowiednie dopasowanie do sylwetki, dekolt w kształcie litery V, wykończone lamówką, bluza wyposażona w trzy kieszenie. Dwie kieszenie dolne o wymiarach min. 16 cm x 16 cm, kieszeń górna o wymiarach min. 12 cm x 10 cm. Bluza w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 70 cm do 80 cm). Na złożonej, zapakowanej bluzie widoczne naszywki z nazwą producenta. Spodnie z regulacją rozmiaru w postaci wiązanej taśmy, wyposażone w dużą, głęboką kieszeń (o wymiarach min. 20 cm x 15 cm), umieszczoną na boku nogawki. Zakończone podszyciem, nie strzępiące się. Spodnie w rozmiarach XS – 3XL (tj. o długości od 103 cm do 122 cm). Dostępne w kolorach: niebieskim i zielonym. Spodnie i bluzy pakowane pojedynczo w woreczki polietylenowe PE z etykietą zawierającą min. znak CE, rozmiar, numer katalogowy, opis w języku polskim, kod kreskowy EAN – 128 kodujący co najmniej datę produkcji i nr partii. Pakowane po 50 sztuk spodni lub bluz w kartonie transportowym.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

33

pakiet 8, poz. 2

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy wymaga ubrań chirurgicznych o następujących parametrach:

Koszula, 3 kieszenie

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Długość (A)	70 cm	70 cm	72 cm	75 cm	76 cm	80 cm	80 cm
Szerokość (B)	49 cm	52 cm	55 cm	60 cm	65 cm	72 cm	78 cm

Spodnie, wiązane w pasie, 1 kieszeń

Rozmiar	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Długość (C)	103 cm	104 cm	105 cm	109 cm	112 cm	116 cm	122 cm
Szerokość (D)	45 cm	50 cm	53 cm	58 cm	65 cm	70 cm	73 cm

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

34

pakiet 8, poz. 1

**Pytanie:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego z rękawami (łączenie klejone) w rozmiarach S/M (dł. 115cm), L (dł. 120cm), XL (dł. 140cm), XL (dł. 150cm), 2XL (dł. 160cm) pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.