



Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich jest jednostką ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

Siemianowice Śląskie, 9.01.2025 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej”, sprawa nr CLO/ZP/53/2024

Pytanie 1:

Pakiet 3 poz. 3

Prosimy o podanie dokładnego modelu aparatu (typu), do którego ma być przeznaczona elektroda.

Odpowiedź:

Elektroda do defibrylatora AED CU Medical I- PAD SP1/SP2 preconnect.

Pytanie 2:

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia (producent, numer katalogowy producenta). Obecny zapis nie pozwala nam na dopasowanie żadnego asortymentu.

Odpowiedź:

MORTARA ELI 250 Model C WAM.

Pytanie 3:

Pakiet 3 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie elektrod z żelazem ciekłym bądź dopuszczenie elektrod pakowanych po 50 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza elektrody z żelazem ciekłym. Zamawiający nie dopuszcza elektrod pakowanych po 50 sztuk. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ.

Pytanie 4:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

2. Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 5:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

4. Kleszczyki biopsyjne jumbo jednokrotnego użytku, kolonoskopowe, tyżeczki owalne, bez igły, średnica 3,0mm, długość robocza 230 cm, rozwarcie tyżeczki 8,5 mm. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

adres: ul. Jana Pawła II 2, 41-100 Siemianowice Śląskie,
REGON 272165010, NIP 6431005873, BDO 000023149
centrala 32 7357 696 / Biuro Dyrektora 32 7357 600 / fax 32 7357 603 / email: clo@clo.com.pl
konto bankowe: ING Bank Śląski o/Siemianowice Śląskie 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537

forma prawna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
KRS nr 0000182167 prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Nr 13790



www.clo.com.pl

Pytanie 6:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

5. Kleszczyki biopsyjne jednokrotnego użytku, gastroskopowe, tyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, rozwarcie tyżeczki **6,7 mm**, długość robocza 180 cm do kanału operacyjnego 2,8 mm. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 7:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

6. Ustnik jednorazowy z **paskiem tekstylnym, 27x22 mm**. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 8:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

7. Szczoteczki do czyszczenia bronchoskopów, średnica szczoteczki 3 mm, długość **230 cm**. Jednokrotnego użytku. Wyrób medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 9:

Czy zamawiający dopuści:

Pakiet 16

10. Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku, pokrywane, tyżeczki owalne z okienkiem, bez igły, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalne rozwarcie miseczki **6,7 mm**. Wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 10:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu 0,38 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 11:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy przewodu 0,38 mm, średnica pętli 5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie kleszczy o rozwarciu 8,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o rozwarciu 7 mm i długości tyżeczek 3 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 14:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ustników o wymiarach 27 mm x 22 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 15:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie szczotek o długości 120 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 16:

Pakiet 16

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie kleszczy o rozwarciu 7 mm, długości tyżeczek 3 mm, objętość miseczki 6,8 mm³.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 17:

Pakiet nr 7 poz.9 „Przetwornik”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz.9 z pakietu nr 7 i utworzenie nowego, odrębnego pakietu 7a, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji z pakietu. Oczekuje produktu zgodnego z SWZ.

Pytanie 18:

Pakiet nr 7 poz.9 „Przetwornik”

Czy Zamawiający dopuści w poz.9 przetwornik do pomiaru ciśnień o długości 160 cm (130 + 30 cm) lub 150cm (120+30cm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie precyzuje długości przetwornika.

Pytanie 19:

Pakiet nr 7 poz.9 „Przetwornik”

Która końcówka łączy przetwornik z kablem monitora w poz.9?

Connectors available




Odpowiedź:

Końcówka przetwornika łączy się z kablem Edward.

Pytanie 20:

Pakiet nr 7 poz.9 „Przetwornik”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.9 przetworników do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną zgodnie z poniższym schematem?:

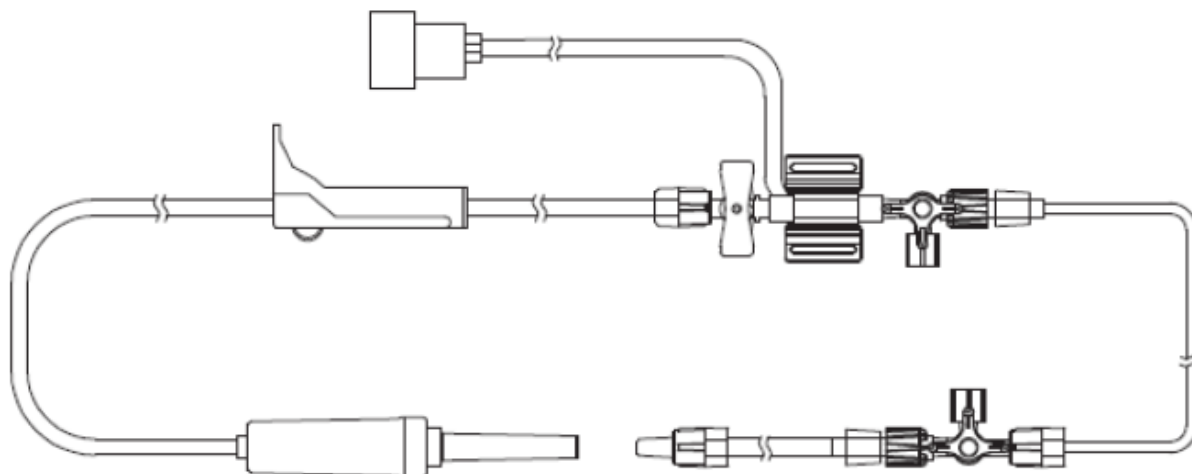

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnego z zapisem SWZ.

Pytanie 21:

Pytanie nr 1 Pakiet nr 4 Pozycja 9

Prosimy o doprecyzowanie do podłączenia jakiego instrumentu kabla wymaga Zamawiający, czy chodzi o kabel do pincet bipolarnych? Czy kabel do innego instrumentu bipolarnego?

Odpowiedź:

Jest to kabel do pincet bipolarnych. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ.

Pytanie 22:

Pytanie nr 2 Pakiet nr 4 Pozycja 10

Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa prosta, średnica **0,8** mm x 29 mm, długość 65 mm, średnica trzpienia 2,4 mm.

Odpowiedź:

Poprawna średnica to 0,8 mm. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ.

Pytanie 23:

Pytanie nr 3 Pakiet nr 4 Pozycja 11

Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa prosta, średnica **0,8** mm x 29 mm, długość 65 mm, średnica trzpienia 4 mm.

Odpowiedź:

Poprawna średnica to 0,8 mm. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ.

Pytanie 24:

Pytanie nr 4 Pakiet nr 4 Pozycja 12

Prosimy o doprecyzowanie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli: Elektroda igłowa prosta, **izolowana**, średnica 0.5 mm x 3 mm, wolframowa, długość 55 mm, średnica trzpienia 2.4 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli elektrodę igłową prostą, izolowaną. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SWZ.

Pytanie 25:

Pakiet 16

Poz. 1 . Czy Zamawiający pętle o średnicy przewodu 0,3 mm? Wszystkie pętle obrotowe. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 26:

Pakiet 16

Poz. 2. Czy Zamawiający pętle o średnicy przewodu 0,3 mm? Wszystkie pętle obrotowe. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 27:

Pakiet 16

Poz. 6. Czy Zamawiający dopuści ustniki szerokość 27 i wysokość 22? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 28:

PAKIET 1

Prosimy o dopuszczenie ostrzy innych, niż do strzygarki 3M pod warunkiem nieodpłatnego użyczenia strzygarek kompatybilnych z zaferowanymi ostrzami na czas realizacji umowy. Strzygarka kompatybilna z oferowanymi ostrzami posiada trzyczakresową obrotową głowicę: 45° w lewo, 0° i 45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. W przypadku dopuszczenia prosimy o podanie liczby potrzebnych strzygarek. Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, jednorazowego użytku, do strzygarki chirurgicznej z nieruchomym ostrzem, uniwersalne. Ostrza mikrobiologicznie czyste jednokrotnego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza 36 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry – ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu; pakowane: 1 szt / blister; 50 blistrów/ pudełko.

Opis strzygarki zaproponowanej na użyczenie:

- Strzygarka służąca do usuwania owłosienia przed zabiegami operacyjnymi bez możliwości zacięcia skóry, lekka, ergonomiczna, wyposażona w trzyczakresową, obrotową głowicę(kąt00, kąt 45° w lewo, kat 45° w prawo), do stosowania na mokro i sucho.
- Czas ładowania strzygarki: maksimum 120 minut.
- Strzygarka wyposażona w wyświetlacz cyfrowy LED sygnalizującą stopień naładowania baterii, oraz antypoślizgowy, ergonomiczny uchwyt zapobiegający obrażeniom w wyniku wyślizgnięcia się strzygarki.
- Wysoko wydajna bateria Li-ion , 3,7V ICR 18650MAB 1800mAh
- Czas pracy strzygarki: 150 minut
- W komplecie ładowarka z możliwością postawienia na biurku lub przymocowania do powierzchni pionowych.
- Strzygarka z możliwością mycia pod bieżącą wodą oraz możliwością dezynfekcji zanurzeniowej (klasa szczelności min. IPX7).
- Niski poziom hałasu: max 60dB
- Strzygarka kompatybilna z min. 2 rodzajami ostrzy: uniwersalnymi przeznaczonymi do usuwania owłosienia z całego ciała i z ostrzami typu neuro do usuwania gęstego owłosienia.

- Bezkontaktowy i higieniczny montaż ostrza na głowicy, zdejmowanie ostrza tnącego jedną ręką
- Konstrukcja strzygarki uniemożliwiająca uszkodzenie skóry – brak kontaktu ostrzy z powierzchnią skóry
- Waga strzygarki: 132g (bez ostrzy), 142g (z ostrzami)
- Wolna od lateksu i ftalanów
- Wymiary strzygarki (z założonym ostrzem): 151x46x35 mm (długość. x szerokość. x głębokość)
- Wysokość strzyżenia: 0,3 mm
- Zarejestrowana jako wyrób medyczny.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 29:

PAKIET 8

Prosimy o dopuszczenie mankietów dla obwodu kończyny 25-35cm, szerokość mankieta 14,5 cm, dezynfekcja powierzchniowa - 70% etanol lub 70% izopropanol, gwarancja 6 m-cy. Prosimy o odstąpienie od wymogu " wyposażony w zatyczkę wodoszczelną", i "żywołność worka wynosi min 30000 cykli".

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 30:

PAKIET 21

Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:

- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych

-Cocoon

-WarmTouch

-Bair Hugger Model 505 Warming unit/ Bair Hugger Model 775

-Mistral-Air

-WarmAir Convective Warming

-Patient Warming System PWS 71000

-Calima™ Forced Air Warming.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 31:

PAKIET 21

Prosimy o dopuszczenie kocy na całe ciało dla pacjenta dorosłego 195 x 100 cm.



Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 32:

PAKIET 21

Prosimy o dopuszczenie kocy pakowanych po 10 sztuk w opakowaniu zbiorczym i jednocześnie zwiększenie zapotrzebowania do 1010 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 33:

PAKIET 23

1. Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem regulacji temperatury 30-40°C co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie - 30-39°C co 0,1°C dla noworodków - urządzenie automatycznie ustala limit w zależności od typu podłączonego elementu grzewczego.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 34:

PAKIET 23

2. Prosimy o dopuszczenie materaca posiadającego jedną powierzchnię grzewczą. Oznaczenie ciepłej strony elementu grzewczego na pokrowcu zewnętrznym w postaci piktogramu i tekstu.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 35:

PAKIET 23

3. Prosimy o dopuszczenie dwustopniowego zabezpieczenia przed przegrzaniem: alarm wysokiej temperatury aktywowany przy progu temperatury 41,1 °C powoduje odcięcie ogrzewania oraz wyłącznik mechaniczny odcinający zasilanie przy temp. 42-43 °C.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

Pytanie 35:

PAKIET 23

4. Prosimy o dopuszczenie materaców i pokrowców, które możemy czyścić ogólnodostępnymi środkami czystości (w tym na bazie alkoholu) oraz pokrowców z możliwością prania w temp. 95°C.

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje przedmiotu zgodnego z SWZ.

